

分析機器管理システム ユーザーマニュアル

Ver. 1.04


共用設備基盤センター

2020 年 2 月 14 日

目次


1	機器利用の流れ.....	2
2	利用機器を予約する場合の手順.....	3
2.1	ユーザー登録.....	3
2.2	機器の予約.....	4
3	利用できる機器を検索して予約する場合の手順.....	8
3.1	機器の検索.....	8
3.2	ユーザー登録.....	9
3.3	機器の予約.....	10
4	予約のキャンセル.....	13
5	予約時間の変更.....	14
6	ブックマークについて.....	16
6.1	ブックマーク登録.....	16
6.2	ブックマーク解除.....	17
7	問い合わせについて.....	18
7.1	機器の問い合わせ.....	18
7.2	機器予約の問い合わせ.....	19
8	集計管理について.....	21

1 機器利用の流れ

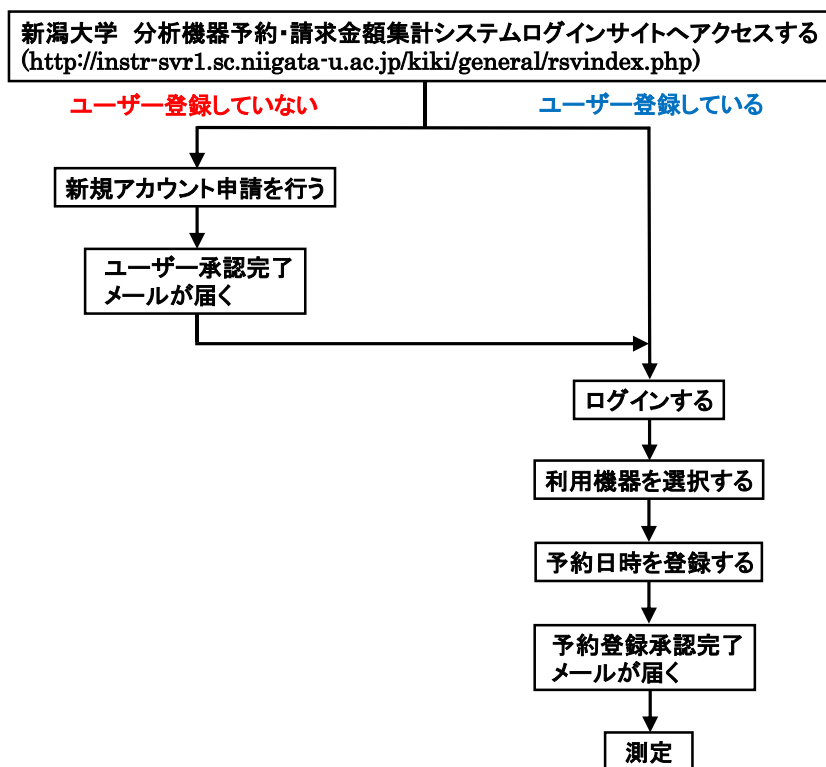

《利用機器を予約する場合》

《利用できる機器を検索して予約する場合》

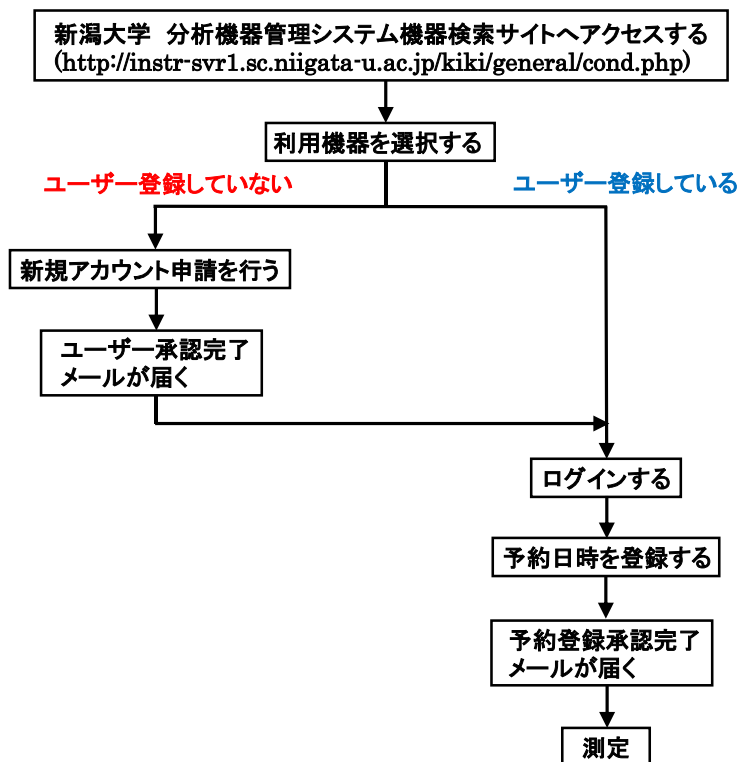

2 利用機器を予約する場合の手順

2.1 ユーザー登録

ユーザー登録してユーザーアカウントを取得します。

ユーザー登録は、指導教員及び教員のみ行うことができます。


学生は、指導教員のユーザーアカウントを使用して機器の予約を行ってください。

- ① 新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システムのサイトへアクセスします。


<http://instr-svr1.sc.niigata-u.ac.jp/kiki/general/rsvindex.php>

現在、このサイトは学内からのみアクセス可能となっています。

- ② ログイン画面が表示されます。[新規アカウント申請]をクリックします。

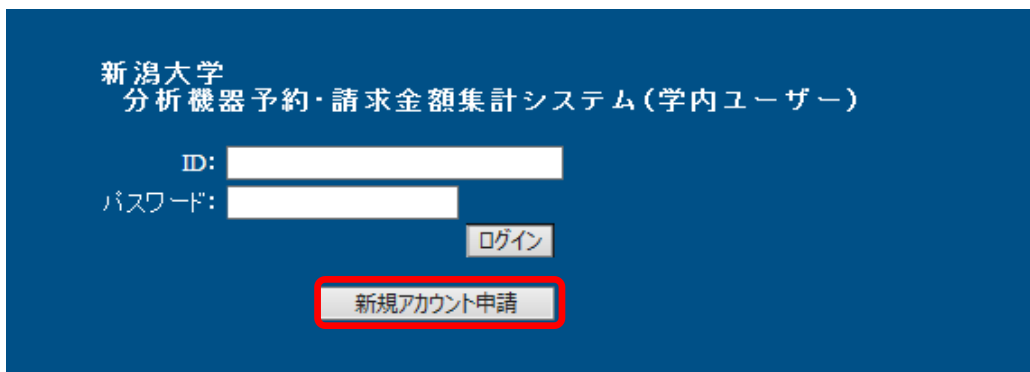

- ③ 学内アカウント申請画面が表示されます。必要事項を記入し、[確認画面へ]をクリックします。確認画面で入力ミスがない事を確認し、[送信]をクリックします。

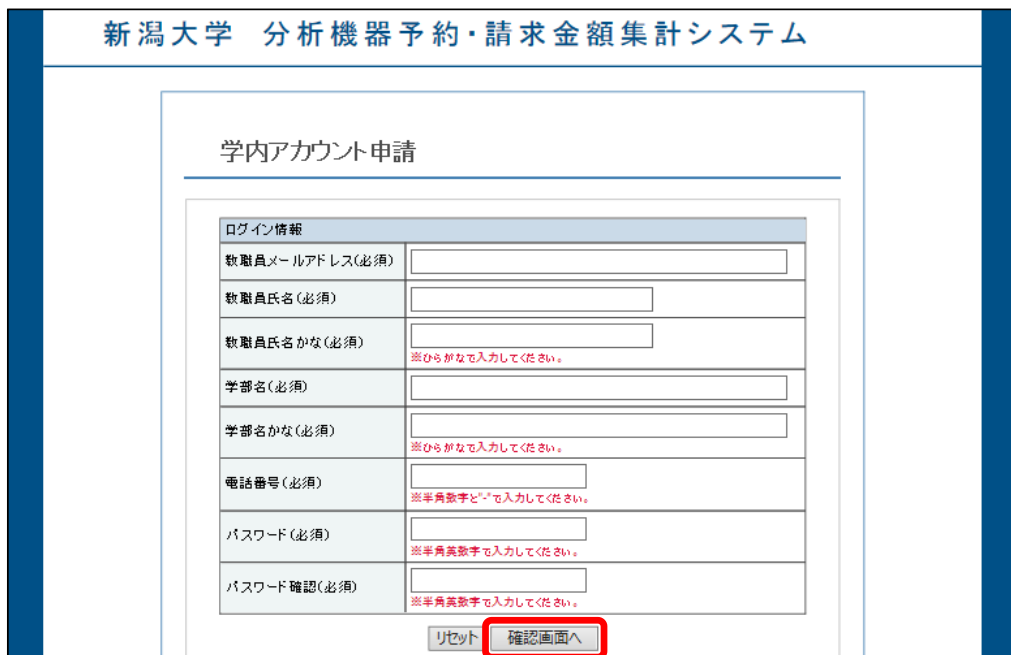

システム管理者より「ユーザー承認完了」メールが送信され、システムにログイン可能になります。24 時間以内にメールが届かない場合は、analys@cc.niigata-u.ac.jp にお問い合わせください。

2.2 機器の予約

- ① 分析機器予約・請求金額集計システムにログインする。

<http://instr-svr1.sc.niigata-u.ac.jp/kiki/general/rsvindex.php>

ID（メールアドレス）、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログイン ID は申請時の「教職員メールアドレス」、パスワードは申請時のパスワードです。

- ② 利用機器の検索を行います。

ブックマークリスト画面が表示されます。学内メニューの【分析機器検索】をクリックします。

新潟大学 分析機器予約システム

岩船勝敏 ログアウト 学内メニュー 分析機器検索 予約管理 問い合わせ管理 集計管理 ブックマーク パスワード変更	ブックマークリスト 1/1 頁(件中)						
	装置番号	機器の名称	購入年月	管理者	管理部署	稼働状況 ○：稼働可 ×：稼働不可	共用利用 *：学外可 ○：学内可 △：特定ユーザー可 ×：不可
		卓上型粉末XRD	2015/3/	岩船 勝敏	研究支援部 (研究支援)	○	○ *
	2018年12月 <<前週 次週>>						
	M20140007355	金	十	日	月	火	水

- ③ 分析機器検索画面が表示されます。利用する機器名やキーワードを入力して[検索]ボタンをクリックします。または、カテゴリを選択して[検索]ボタンをクリックします。

新潟大学 分析機器管理システム

一般
学内メニュー
分析機器検索
予約管理
問い合わせ管理
集計管理
ブックマーク
パスワード変更

分析機器検索

予約の可否：
☒ 可能+問い合わせのみ ☐ 可能のみ ☐ 問い合わせのみ

表示件数:

カテゴリ:

- X線分析 (XRD, XRF, EPMAなど)
- 光分析 (吸光, 発光, ラマン分析など)
- 磁気共鳴分析 (NMR, ESRなど)
- 質量分析 (GC-MS, LC-MSなども含む)
- クロマトグラフィー (GC, HPLCなど)
- 電気分析
- 熱分析 (TG, DSCなど)
- 元素分析
- DNA関連分析

- ④ 該当する機器のリストが表示されます。利用したい機器の名称をクリックします。
リストの表示はタイトル行の各項目をクリックして並び替えることができます。

新潟大学 分析機器管理システム

分析機器リスト 1/1 頁 (4 件中)

資産番号	機器の名称	購入年月	管理者	管理部屋▲	稼働状況 ○:稼働可 ×:稼働不可	共同利用 *:学外可 ○:学内可 △:特定ユーザー可 ×:不可
201003260001	卓上型単結晶XRD	2010/03	岩船 勝敏	工学部事務部	○	○ *
M20140002255	卓上型粉末XRD	2015/3/	岩船 勝敏	研究支援部 (研究支援)	○	○ *
200303140001	粉末XRD-RINT2500HR	2003/03	岩船 勝敏	研究支援部 (研究支援)	○	○ *
L007-0001-000						
200810300002	島津EPMA1610	2008/10	五十嵐 文子	研究支援部 (研究支援)	○	○ *

- ⑤ 機器詳細画面が表示されます。画面の[予約]をクリックします。

新潟大学 分析機器管理システム

機器詳細

機器の名称	卓上型粉末X線回折装置
管理部署	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20140002255
購入年月日	2015/3/6
カテゴリ	X線分析 (XRD, XRF, EPMAなど)

リストへ戻る 機器問い合わせ **予約** ブックマーク登録

どちらでもOK

機器の詳細な情報

どのような分析・計測ができるのか

粉末X線回折測定

機器の仕様

Bruker D2Phaser

機器の写真



1

リストへ戻る 機器問い合わせ **予約** ブックマーク登録

- ⑥ カレンダー設定画面が表示されます。予約したい日にちをクリックします。

カレンダー設定

機器の名称	卓上型粉末X線回折装置
管理部署	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20140002255
購入年月日	2015/3/6
カテゴリ	X線分析 (XRD, XRF, EPMAなど)
連絡先氏名	岩崎 勝敏
連絡先内線番号	6797
連絡先メールアドレス	irafune@eng

機器詳細確認

2016年09月

次月>>

月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4
			×	×	×	×
5	6	7	8	9	10	11
×	×	×	×	×	×	×
12	13	14	15	16	17	18
×	×	×	×	×	×	×
19	20	21	22	23	24	25
×	×	×	×	×	×	×
26	27	28	29	30		
×	×	×	△	○		

○:終日予約可 △:一部可 □:メンテナンス ×:予約不可

問い合わせ

リストへ戻る

- ⑦ タイムテーブル/予約設定画面が表示されます。検査情報から予約する検査を選択します。

検査情報				
	検査名	集計単位	受付時間	料金
☒	卓上型粉末XRD	60分	24H	昼 250円(300円) 夜 300円
☐	aaa	15分	24H	7円(6円)

- ⑧ 機器予約情報内の[通常予約] [複数期間予約]のどちらかを選択して下さい。
 [通常予約]では、単独の期間で予約を行います。[複数期間予約]では、同じ時間を複数の期間で、繰り返して予約することが出来ます。
 [複数期間予約]では、予約日欄の[⊕]マークをクリックすると、選択出来る期間が追加されます。[⊖]マークをクリックすると、選択出来る期間が削除されます。

機器予約情報	
☐ 通常予約 ☒ 複数期間予約	
予約時間(必須)	09 : 00 ~ 10 : 00
予約日(必須)	2020/02/17 ~ 2020/02/17 + 2020/02/18 ~ 2020/02/18 -
予約者名(必須)	
連絡用メールアドレス	
検体数	検体
請求金額(必須)	0 自動計算されます。
質問事項 質問事項がある場合のみ入力してください。	
質問者氏名	
質問者メールアドレス	

- ⑨ 画面下部の「確認」をクリックします。
- ⑩ 機器予約登録確認画面が表示されます。
 入力ミスがない事を確認し、画面下部の[登録]をクリックします。
 機器の予約が完了し、連絡用メールアドレスに「予約登録承認」メールが送信されます。
 学内メニューの【予約管理】をクリックすると予約リストが表示され、予約状況を確認できます。

ログアウト

機器管理者メニュー

予約管理

機器予約設定管理

問い合わせ管理

集計管理

パスワード変更

予約リスト

検索タイプ

☒管理機器予約☐自分の予約のみ

検索条件

キャンセル☐含む☒含まない

検索範囲

~

再検索

全選択

チェックの解除

承認

キャンセル

削除

1/1頁(11件中)

	資産番号	資産名称	予約タイプ	検査名	集計タイプ	予約者名	予約開始日	予約終了日	承認
☐	201004010014	VarianNMR400MHz	学内予約	Varian400MHzNMR	時間単位		2019/01/25 14:45:00	2019/01/25 14:50:00	済

3 利用できる機器を検索して予約する場合の手順

3.1 機器の検索

- ① 新潟大学 分析機器管理システム機器検索サイトへアクセスします。

<http://instr-svr1.sc.niigata-u.ac.jp/kiki/general/cond.php>

現在、このサイトは学内からのみアクセス可能となっています。

- ② 分析機器検索画面が表示されます。利用する機器名やキーワードを入力して[検索]ボタンをクリックします。または、カテゴリを選択して[検索]ボタンをクリックします。

新潟大学 分析機器管理システム

一般
学内メニュー
分析機器検索
予約管理
問い合わせ管理
集計管理
ブックマーク
パスワード変更

分析機器検索

検索 リセット

予約の可否：
☒ 可能+問い合わせのみ ☐ 可能のみ ☐ 問い合わせのみ

表示件数：25件 ▼

カテゴリ：
 X線分析 (XRD, XRF, EPMAなど)
 光分析 (吸光, 発光, ラマン分析など)
 磁気共鳴分析 (NMR, ESRなど)
 質量分析 (GC-MS, LC-MSなども含む)
 クロマトグラフィー (GC, HPLCなど)
 電気分析
 熱分析 (TG, DSCなど)
 元素分析
 DNA関連分析

- ③ 該当する機器のリストが表示されます。利用したい機器の名称をクリックします。
リストの表示は、タイトル行の各項目をクリックして並びかえることができます。

新潟大学 分析機器管理システム

分析機器リスト 1/1 頁 (4件中)

資産番号	機器の名称	購入年月	管理者	管理部署▲	稼働状況 ○：稼働可 ×：稼働不可	共用利用 *：学外可 ○：学内可 △：特定ユーザー可 ×：不可
201003260001	桌上型単結晶XRD	2010/03	岩船勝敏	工学部事務部	○	○*
M20140002235	桌上型粉末XRD	2015/3/	岩船 勝敏	研究支援部 (研究支援)	○	○*
200303140001 L007-0001-000	粉末XRD-RINT2500HR	2003/03	岩船 勝敏	研究支援部 (研究支援)	○	○*
200810300002	島津EPMA1610	2008/10	五十嵐文子	研究支援部 (研究支援)	○	○*

④ 機器詳細画面が表示されます。

機器の予約をする場合は、画面の[予約]をクリックします。ログイン画面が表示されますので、3.2 及び 3.3 を参照し、ログイン及び予約を行ってください。

新潟大学 分析機器管理システム

機器詳細

機器の名称	卓上型粉末X線回折装置
管理部署	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20140002255
購入年月日	2015/3/6
カテゴリ	X線分析 (XRD, XRF, EPMAなど)

リストへ戻る 機器問い合わせ 予約 ブックマーク登録/解除

機器の仕様: Bruker D2Phaser

機器の写真: [Image of Bruker D2Phaser]

リストへ戻る 機器問い合わせ 予約 ブックマーク登録/解除

どちらでもOK

3.2 ユーザー登録

ユーザー登録してユーザーアカウントを取得します。

ユーザー登録は、指導教員及び教員のみ行うことができます。

学生は、指導教員のユーザーアカウントを使用して機器の予約を行ってください。

- ① 検索サイトから機器を検索し、機器詳細画面の[予約]をクリックすると、ログイン画面が表示されますので、[新規アカウント申請]をクリックします。

新潟大学
分析機器予約・請求金額集計システム(学内ユーザー)

ID:

パスワード:

ログイン

新規アカウント申請

- ② 学内アカウント申請画面が表示されます。必要事項を記入し、[確認画面へ]をクリックします。確認画面で入力ミスがない事を確認し、[送信]をクリックします。

新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システム

学内アカウント申請

ログイン情報	
教職員メールアドレス(必須)	
教職員氏名(必須)	
教職員氏名かな(必須)	 ※ひらがなで入力してください。
学部名(必須)	
学部名かな(必須)	 ※ひらがなで入力してください。
電話番号(必須)	 ※半角数字と“-”で入力してください。
パスワード(必須)	 ※半角英数字で入力してください。
パスワード確認(必須)	 ※半角英数字で入力してください。

システム管理者より「ユーザー承認完了」メールが送信され、システムにログイン可能になります。24 時間以内にメールが届かない場合は、analys@cc.niigata-u.ac.jp にお問い合わせください。

3.3 機器の予約

- ① 検索サイトから機器を検索し、機器詳細画面の[予約]をクリックすると、ログイン画面が表示されます。

ID (メールアドレス)、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログイン ID は申請時の「教職員メールアドレス」、パスワードは申請時のパスワードです。

新潟大学
分析機器予約・請求金額集計システム(学内ユーザー)

ID:

パスワード:

- ② カレンダー設定画面が表示されます。予約したい日にちをクリックします。

カレンダー設定

機器の名称	桌上型粉末X線回折装置
管理部署	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20140002255
購入年月日	2015/3/6
カテゴリ	X線分析(XRD, XRF, EPMAなど)
連絡先氏名	岩船 勝敏
連絡先内線番号	6797
連絡先メールアドレス	iyafune@eng

機器詳細確認

2016年09月

次月>>

月	火	水	木	金	土	日
			1 ×	2 ×	3 ×	4 ×
5 ×	6 ×	7 ×	8 ×	9 ×	10 ×	11 ×
12 ×	13 ×	14 ×	15 ×	16 ×	17 ×	18 ×
19 ×	20 ×	21 ×	22 ×	23 ×	24 ×	25 ×
26 ×	27 ×	28 ×	29 △	30 ○		

○:終日予約可 △:一部可 □:メンテナンス ×:予約不可

問い合わせ

リストへ戻る

- ③ タイムテーブル/予約設定画面が表示されます。検査情報、機器予約情報を入力し、[確認]をクリックします。質問がある場合は質問事項も入力して下さい。

タイムテーブル/予約設定

機器の名称	桌上型粉末X線回折装置
管理部署	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20140002255
購入年月日	2015/3/6
カテゴリ	X線分析(XRD, XRF, EPMAなど)
連絡先氏名	岩船 勝敏
連絡先電話番号	6797
連絡先メールアドレス	iwa@meiji.ac.jp

機器予約情報確認

タイムテーブル 非表示

2016年09月30日

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

メンテナンス中: ■ 仮予約: ■ 管理者予約: ■ 学内予約: ■ 学外予約: ■

検査情報	検査名	集計単位	受付時間	料金
☒	学内昼間	60分	09:00~17:00	250円
☐	学内夜	60分	17:00~09:00	300円

機器予約情報

予約開始日時(必須) 2016/09/30 11:00

予約終了日時(必須) 2016/09/30 13:00

予約者名(必須)

連絡用メールアドレス※

請求金額(必須) 500
自動計算されます。

質問事項 質問事項がある場合のみ入力して下さい。

質問者氏名

質問者メールアドレス

質問内容

返信:

確認

カレンダー表示へ戻る リストへ戻る

※ 連絡用メールアドレスには「予約登録承認」メール及び「請求金額確定」メールを送信いたします。必須ではありません。

- ④ 機器予約登録確認画面が表示されますので、入力ミスがない事を確認し、[登録]をクリックします。
- 連絡用メールアドレスに「予約登録承認」メールが送信され、機器の予約が完了します。
- 学内メニューの【予約管理】をクリックすると予約リストが表示され、予約状況を確認できます。

新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システム

予約リスト

検索条件 検索期間 2016/09/29 ~ 再検索

全選択 チェックの解除 キャンセル

1/1頁(1件中)

	装置番号	装置名称	キャンセル	検索名	集計タイプ	予約者名	予約開始日▲	予約終了日	承認
☐	M20140002255	卓上型粉末X線回折装置	可	学内登録	時間単位	★☆☆	2016/10/07 13:00:00	2016/10/07 15:00:00	済

全選択 チェックの解除 キャンセル

4 予約のキャンセル

- ① システムにログインします。

新潟大学
分析機器予約・請求金額集計システム(学内ユーザー)

ID:

パスワード:

ログイン

新規アカウント申請

- ② ブックマークリスト画面が表示されます。予約管理をクリックします。

新潟大学 分析機器予約システム

ブックマークリスト 1/1頁(1件中)

装置番号	装置の名称	購入年月	管理者	管理部屋	稼働状況 ○:稼働可 ×:稼働不可	共同利用 *:学外可 ○:学内可 △:特定ユーザー可 ×:不可	削除
M20140002255	卓上型粉末XRD	2015/3	■■■■■	研究支援部(研究支援)	○	○*	

2019年1月
<<前月 次月>>

金	土	日	月	火	水	木
1	2	3	4	5	6	7

- ③ キャンセルしたい予約情報にチェックを入れ, [キャンセル]をクリックします。
連絡用メールアドレスに「予約キャンセル」のメールが送信され, 機器予約のキャンセルが完了します。

新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システム

予約リスト

検索条件 検索範囲 2016/09/29 ~ 再検索

全選択 チェックの解除 キャンセル

1/1頁 (1件中)

	装置番号	装置名称	キャンセル	装置名	集計タイプ	予約者名	予約開始日	予約終了日	承認
☒	M20140002255	卓上型粉末X線回折装置	可	学内昼間	時間単位	★★★★	2016/10/07 13:00:00	2016/10/07 15:00:00	済

全選択 チェックの解除 キャンセル

5 予約時間の変更

機器予約詳細画面から, 予約時間(利用時間)を変更することができます。

機器予約詳細

機器の名称 卓上型粉末X線回折装置

管理局 研究支援部(研究支援)

装置番号 M20140002255

タイムテーブル 表示

検査情報

	検査名	集計単位	受付時間	料金
☒	学内昼間	60分	09:00~17:00	250円
☐	学内夜	60分	17:00~09:00	300円

機器予約情報

予約開始日時(必須) 2016/09/21 13:00

予約終了日時(必須) 2016/09/21 16:00

予約者名(必須) ★★★★★

連絡用メールアドレス

請求金額(必須) 750
自動計算されます。

承認

登録 キャンセル

リストへ戻る

- ① 予約リストを表示します。予約時間を変更したい機器の名称をクリックします。

新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システム

予約リスト

検索条件 検索範囲 2016/09/29 ~ 再検索

全選択 チェックの解除 キャンセル

1/1頁(1件中)

	装置番号	装置名称	キャンセル	検査名	集計タイプ	予約者名	予約開始日▲	予約終了日	承認
☐	M20140002255	▲上型粉末X線回折装置	可	学内昼間	時間単位	★★★★	2016/10/07 13:00:00	2016/10/07 15:00:00	済

全選択 チェックの解除 キャンセル


- ② 機器予約詳細画面が表示されます。変更時間を入力し、[登録]をクリックします。
- 予約時間開始前の変更の場合は・・・
- 開始時間, 終了時間を変更することができます。
- 予約時間開始後の変更の場合は・・・
- 終了時間のみ変更することができます。
- ただし, 終了時間まで集計時間が残っている場合に限りです。
- ③ 機器予約登録確認画面が表示されますので, 入力ミスがない事を確認し, [登録]をクリックします。
- 連絡用メールアドレスに「予約更新承認」メールが送信され, 予約時間の変更が完了します。

6 ブックマークについて

よく利用する機器をブックマーク登録しておくと、ログイン後すぐにブックマークリストが表示されるので便利です。

6.1 ブックマーク登録

ブックマーク登録をしたい機器の機器詳細画面を表示し、[ブックマーク登録]をクリックします。

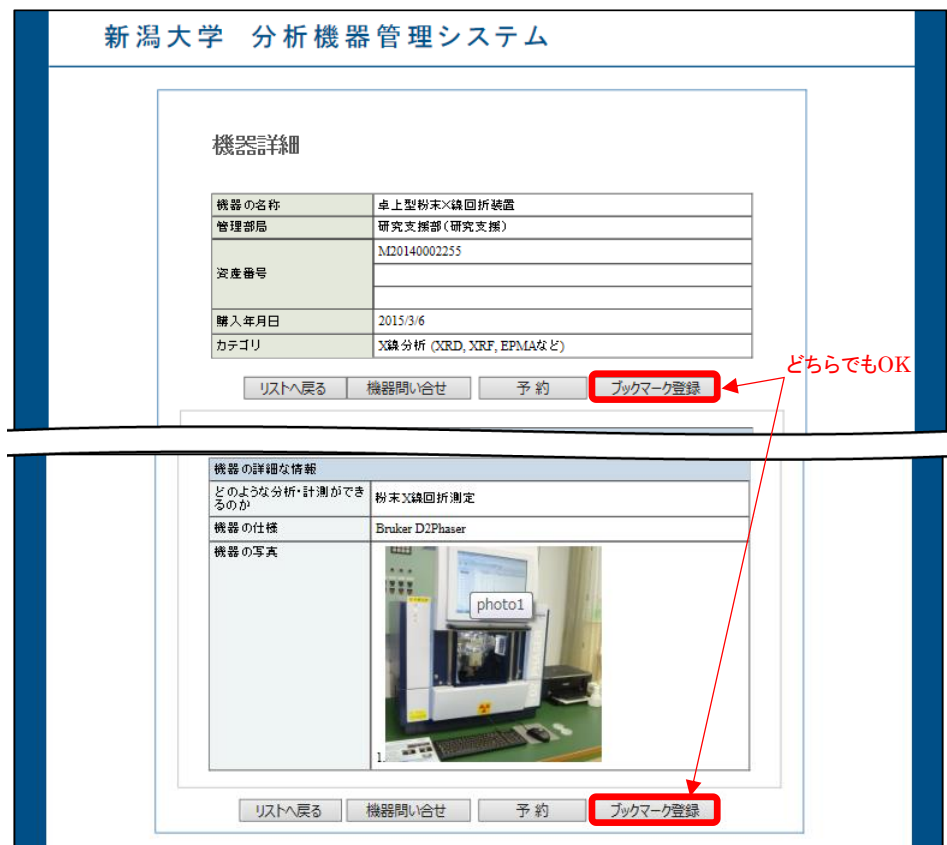

学内メニューの【ブックマーク】をクリックすると、ブックマーク登録された機器のリスト一覧が表示されます。

6.2 ブックマーク解除

《解除方法 1》

学内メニューの【ブックマーク】をクリックし、ブックマークリスト一覧を表示します。ブックマーク登録を解除したい機器の右側にある[削除]をクリックするとブックマーク登録が解除されます。

新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システム																																							
★☆☆★ ログアウト 学内メニュー 予約管理 問い合わせ管理 集計管理 ブックマーク パスワード変更 分析機器管理		ブックマークリスト 1/1 頁 (件中) <table> <tr> <th>資産番号</th><th>機器の名称</th><th>購入年月</th><th>管理者</th><th>管理部屋</th><th>稼働状況 ○:稼働可 ×:稼働不可</th><th>共同利用 ○:学内外可 △:学内のみ可 ×:不可</th><th>削除</th></tr> <tr> <td>M20150001446</td><td>AVANCE III HD 400 NMR</td><td>2015/12</td><td>岩崎 勝敏</td><td>研究支援部(研究支援)</td><td>○</td><td>○</td><td>削除</td></tr> <tr> <td>M20140002255</td><td>卓上型粉末X線回折装置</td><td>2015/3/</td><td>岩崎 勝敏</td><td>研究支援部(研究支援)</td><td>○</td><td>○</td><td>削除</td></tr> <tr> <td>200810300002</td><td>電子線マイクロアナライザー本体・外</td><td>2008/10</td><td>渡邊孝一</td><td>研究支援部(研究支援)</td><td>○</td><td>○</td><td>削除</td></tr> </table>						資産番号	機器の名称	購入年月	管理者	管理部屋	稼働状況 ○:稼働可 ×:稼働不可	共同利用 ○:学内外可 △:学内のみ可 ×:不可	削除	M20150001446	AVANCE III HD 400 NMR	2015/12	岩崎 勝敏	研究支援部(研究支援)	○	○	削除	M20140002255	卓上型粉末X線回折装置	2015/3/	岩崎 勝敏	研究支援部(研究支援)	○	○	削除	200810300002	電子線マイクロアナライザー本体・外	2008/10	渡邊孝一	研究支援部(研究支援)	○	○	削除
資産番号	機器の名称	購入年月	管理者	管理部屋	稼働状況 ○:稼働可 ×:稼働不可	共同利用 ○:学内外可 △:学内のみ可 ×:不可	削除																																
M20150001446	AVANCE III HD 400 NMR	2015/12	岩崎 勝敏	研究支援部(研究支援)	○	○	削除																																
M20140002255	卓上型粉末X線回折装置	2015/3/	岩崎 勝敏	研究支援部(研究支援)	○	○	削除																																
200810300002	電子線マイクロアナライザー本体・外	2008/10	渡邊孝一	研究支援部(研究支援)	○	○	削除																																

《解除方法 2》

ブックマークを解除したい機器の機器詳細画面を表示します。画面上の[ブックマーク解除]をクリックするとブックマーク登録が解除されます。

新潟大学 分析機器管理システム

機器詳細

機器の名称	卓上型粉末X線回折装置
管理部屋	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20140002255
購入年月日	2015/3/6
カテゴリ	X線分析 (XRD, XRF, EPMAなど)

[リストへ戻る](#)
[機器問い合わせ](#)
[予約](#)
[ブックマーク解除](#)

機器の写真



[リストへ戻る](#)
[機器問い合わせ](#)
[予約](#)
[ブックマーク解除](#)

7 問い合わせについて

7.1 機器の問い合わせ

検索した機器について、予約前に問い合わせを行うことができます。

- ① 問い合わせをしたい機器の機器詳細画面を表示し、[機器問い合わせ]をクリックします。

新潟大学 分析機器管理システム

機器詳細

機器の名称	卓上型粉末X線回折装置
管理部署	研究支援部(研究支援)
資産番号	MD20140002255
購入年月日	2015/3/6
カテゴリ	X線分析 (XRD, XRF, EPMAなど)

リストへ戻る 機器問い合わせ 予約 ブックマーク登録

どちらでもOK

- ② 問い合わせフォームが表示されますので、必要事項を記入し、[確認画面へ]をクリックします。確認画面で入力ミスがない事を確認し、[送信]をクリックします。

「卓上型粉末X線回折装置」に関する問い合わせフォーム

日付: 2016/09/08 14:16:59

※添付ファイルを除く、すべての入力項目に記入してください。
(添付ファイルの指定も可能です)

依頼者

氏名

身分

☒ 学生
☐ 教職員
※依頼者が学生の場合、あらかじめ指導教員の同意を得てください。

学籍番号

所属

電話番号

メールアドレス

指導教員氏名

指導教員電話番号

指導教員メールアドレス

問い合わせ内容

※別紙を添付可能ですが、その場合でも相談内容を簡単に記入してください(S1は文字まで入力可能です)

リストへ戻る リセット 確認画面へ

システム管理者より 24 時間以内にメールが届かない場合は、analys@cc.niigata-u.ac.jpにお問い合わせください。

7.2 機器予約の問い合わせ

機器の予約に関する問い合わせを行うことができます。

- ① 問い合わせをしたい機器の機器詳細画面を表示し、[予約]をクリックします。
- ② カレンダー設定画面が表示されます。[問い合わせ]をクリックします。

カレンダー設定

機器の名称	AVANCE III HD 400 Nanobay
管理部署	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20150001446
購入年月日	2015/12/8
カテゴリ	磁気共鳴分析(NMR, ESRなど)
連絡先氏名	岩船 勝敏
連絡先内線番号	6797
連絡先メールアドレス	iwa@eng

機器詳細確認

2016年09月

次月>>

月	火	水	木	金	土	日
			1 ×	2 ×	3 ×	4 ×
5 ×	6 ×	7 ×	8 ×	9 ×	10 ×	11 ×
12 ×	13 ×	14 ×	15 ×	16 ×	17 ×	18 ×
19 ×	20 ×	21 ×	22 ×	23 ×	24 ×	25 ×
26 ×	27 ×	28 ×	29 ×	30 ○		

○:終日予約可 △:一部可 □:メンテナンス ×:予約不可

問い合わせ

リストへ戻る

- ③ 機器予約問い合わせフォームが表示されますので、必要事項を記入し、[確認]をクリックします。確認画面で入力ミスがない事を確認し、[登録]をクリックします。

機器予約問い合わせ

機器の名称	AVANCEⅢ HD 400 Nanobay
管理部門	研究支援部(研究支援)
資産番号	M20150001446
購入年月日	2015/12/8
カテゴリ	磁気共鳴分析 (NMR, ESRなど)

機器詳細確認

質問者情報

質問者氏名

質問者メールアドレス

質問履歴

質問

確認

カレンダー表示へ戻る

機器管理者より24時間以内にメールが届かない場合は、analys@cc.niigata-u.ac.jpにお問い合わせください。

学内メニューの【問い合わせ管理】をクリックすると問い合わせ一覧が表示され、問い合わせ状況を確認することができます。

新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システム

予約問い合わせ一覧		1/1頁(1件中)		
資産番号1	資産名称	質問者ID	質問者名	状態
M20140002255	桌上型粉末X線回折装置	arasawa@cc.niigata-u.ac.jp		回答済み

8 集計管理について

学内メニューの【集計管理】をクリックすると集計画面が表示されます。

集計条件を入力し, [出力]をクリックすると, 機器利用状況の集計が CSV ファイルで出力されます。

新潟大学 分析機器予約・請求金額集計システム

集計

集計条件選択

期間を入力してください。

2016 年 1 月 ~ 2016 年 1 月

集計タイプを選択してください。

●グループの利用状況

出力